Documento: vital care· SERVICIOS DE INFUSIÓN

Uso de un Regulador de Flujo para Administración por Gravedad

Introducción

Abrazadera de Tubo IV Rueda del Regulador de Flujo i Los reguladores de flujo desechables son accesorios en forma de rueda en el tubo intravenoso (IV) que facilitan a los pacientes controlar el flujo de la medicación a través del conjunto de tubos. También se les conoce como "dial-a-flow".

Pasos
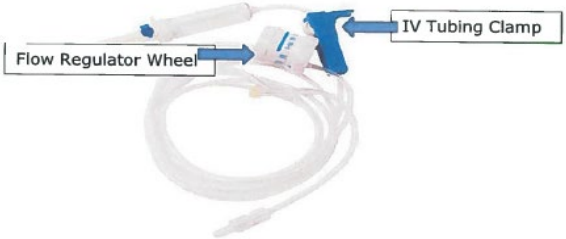
1. Siga las instrucciones estándar para la administración por gravedad del tubo. Su enfermera revisará este proceso paso a paso con usted.
2. Abra la rueda del controlador del tubo a la tasa de flujo más alta disponible o cualquier configuración denominada "abierto" o "cebar".
3. Cierre la abrazadera en el tubo. Puede aparecer como un rodillo de pulgar o deslizante.
4. Inserte la espiga estéril en el contenedor de medicación y cuélguelo del poste IV.
5. Apriete la cámara de goteo hasta llenarla a la mitad.
6. Abra la abrazadera del tubo y cebe el tubo libre de aire.
7. Cierre la abrazadera del tubo.
8. Configure el regulador de flujo a la tasa prescrita por hora según las instrucciones. Su tasa debe ser configurada en: mililitros por hora (ml/hr).
9. Una vez conectado a su catéter IV, abra la abrazadera de rodillo y cuente el número de gotas por 15 segundos.
10. Su cuenta de gotas para 15 segundos debe ser: Su infusión debe completarse en aproximadamente: minutos/horas.